



Об использовании метрологически не аттестованных методик и путях решения их применения лабораториями органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор.

Дашкевич Ж.В., Клещукевич Н.Б.

НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии РЦГЭиОЗ



На основании Закона Республики Беларусь от 11.11.2019 № 254-3 «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» для методик выполнения измерений, не прошедших метрологическую аттестацию, определен переходный период для использования методик в сфере законодательной метрологии не более 5 лет после вступления в силу настоящего Закона, по истечению которого неаттестованные методики невозможно будет использовать в сфере законодательной метрологии.

Метрологическая аттестация методик измерений – это процедура проверки и подтверждения соответствия методик измерений установленным метрологическим требованиям. Она включает в себя анализ и оценку выбора методов, средств измерений, правил проведения измерений и обработки результатов, чтобы убедиться, что методика соответствует требованиям и может быть использована для точных и надежных измерений.

Аттестация методик (методов) измерений – проведение работ по метрологической оценке, в ходе которых проводятся исследования и подтверждение соответствия методик (методов) измерений метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Определено, что все методики измерений, предназначенные для применения в сфере законодательной метрологии, подлежат обязательной аттестации (аттестация методик (методов) измерений – это проведение работ по метрологической оценке, в ходе которых проводятся исследования и подтверждение соответствия методик (методов) измерений метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению). В отношении методик, применяемых вне сферы законодательной метрологии, аттестация проводится в добровольном порядке.

Специалисты ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» совместно с сотрудниками областных и районных центров гигиены и эпидемиологии провели инвентаризацию всех методик, не прошедших процедуру подтверждения метрологической пригодности, используемых в практике осуществления государственного санитарного надзора. Общее количество составило порядка 1600 документов. Перечень был структурирован с учетом классификации (по объектам окружающей среды (вода, воздух, физические факторы и др.) и по форме документа, который содержит методику (МВИ, МУК, МР, МУ и др.)).

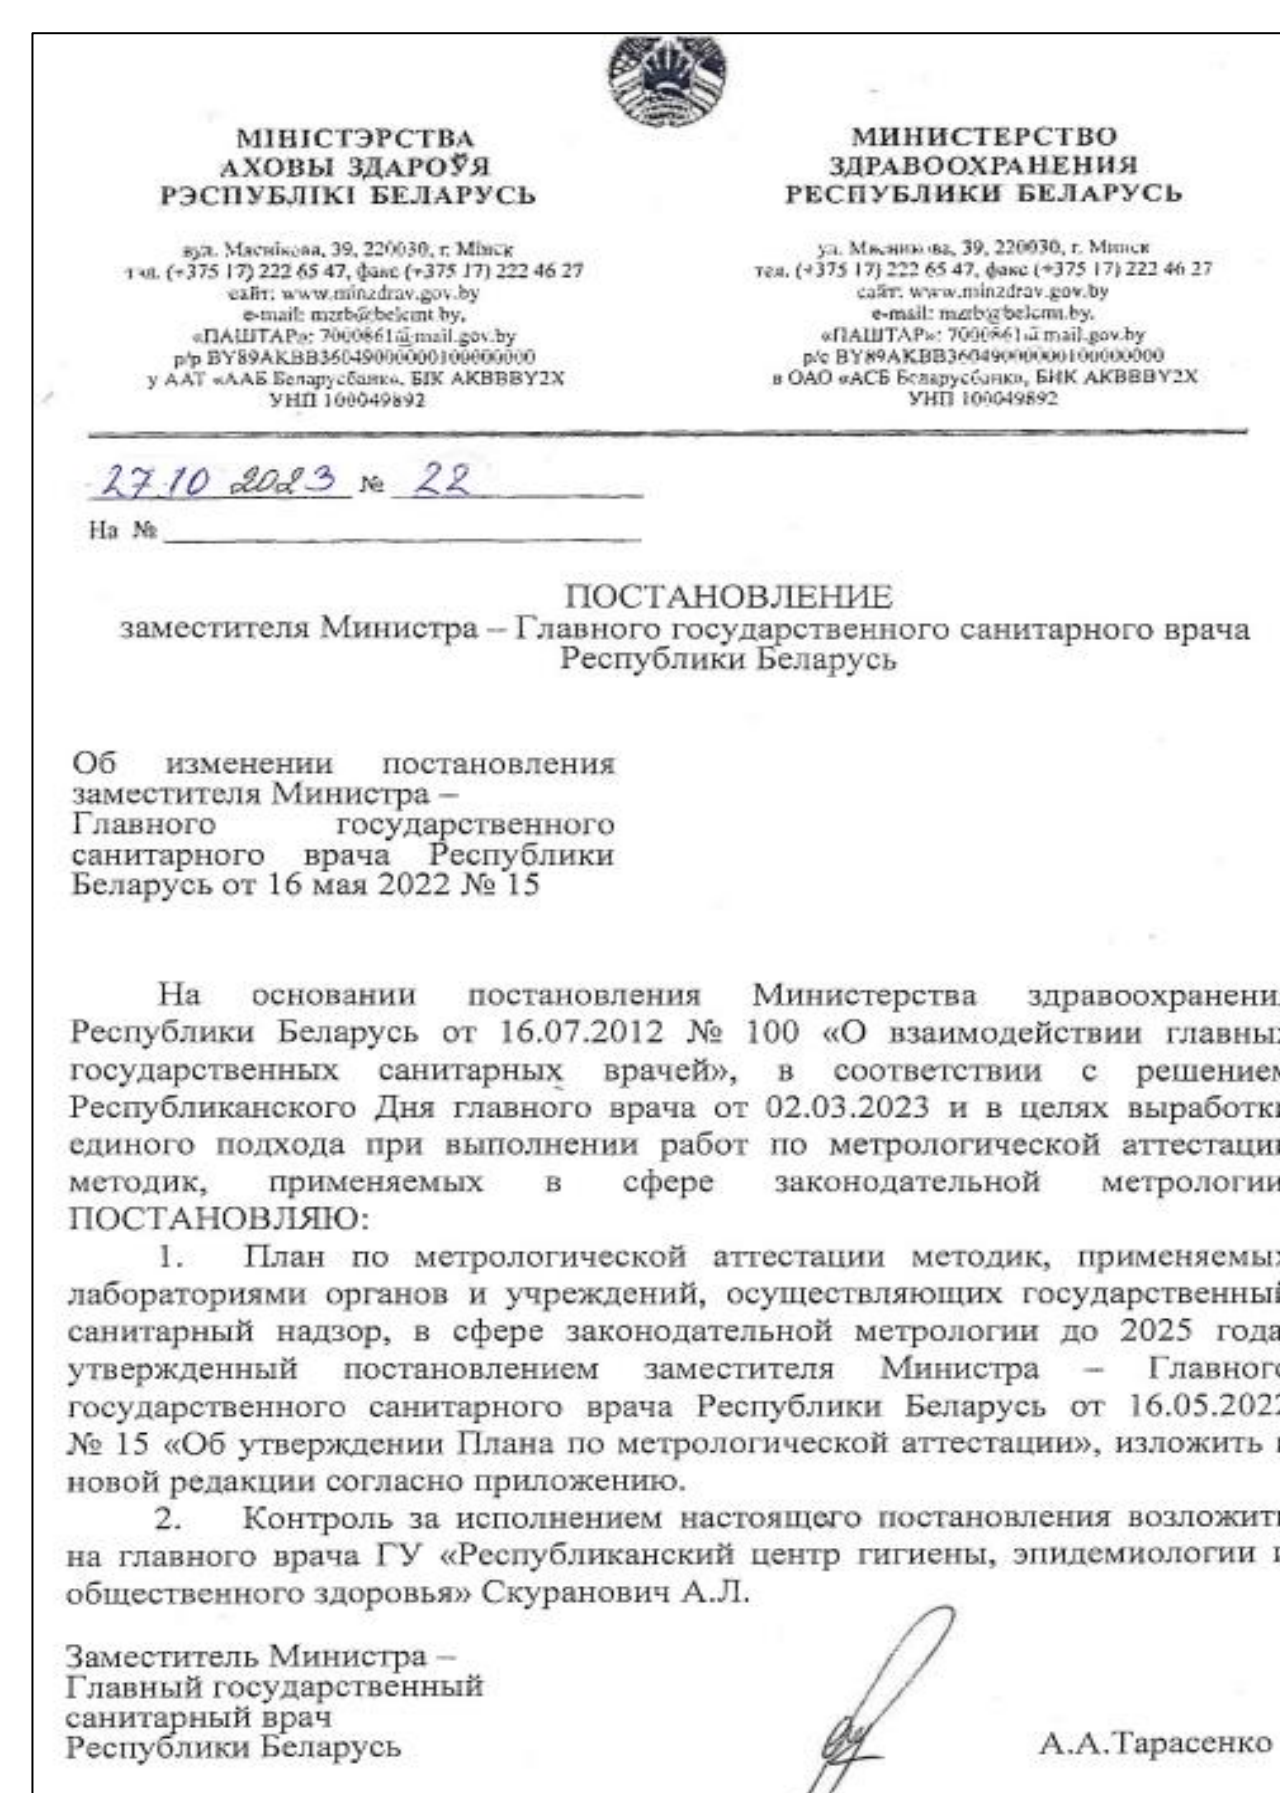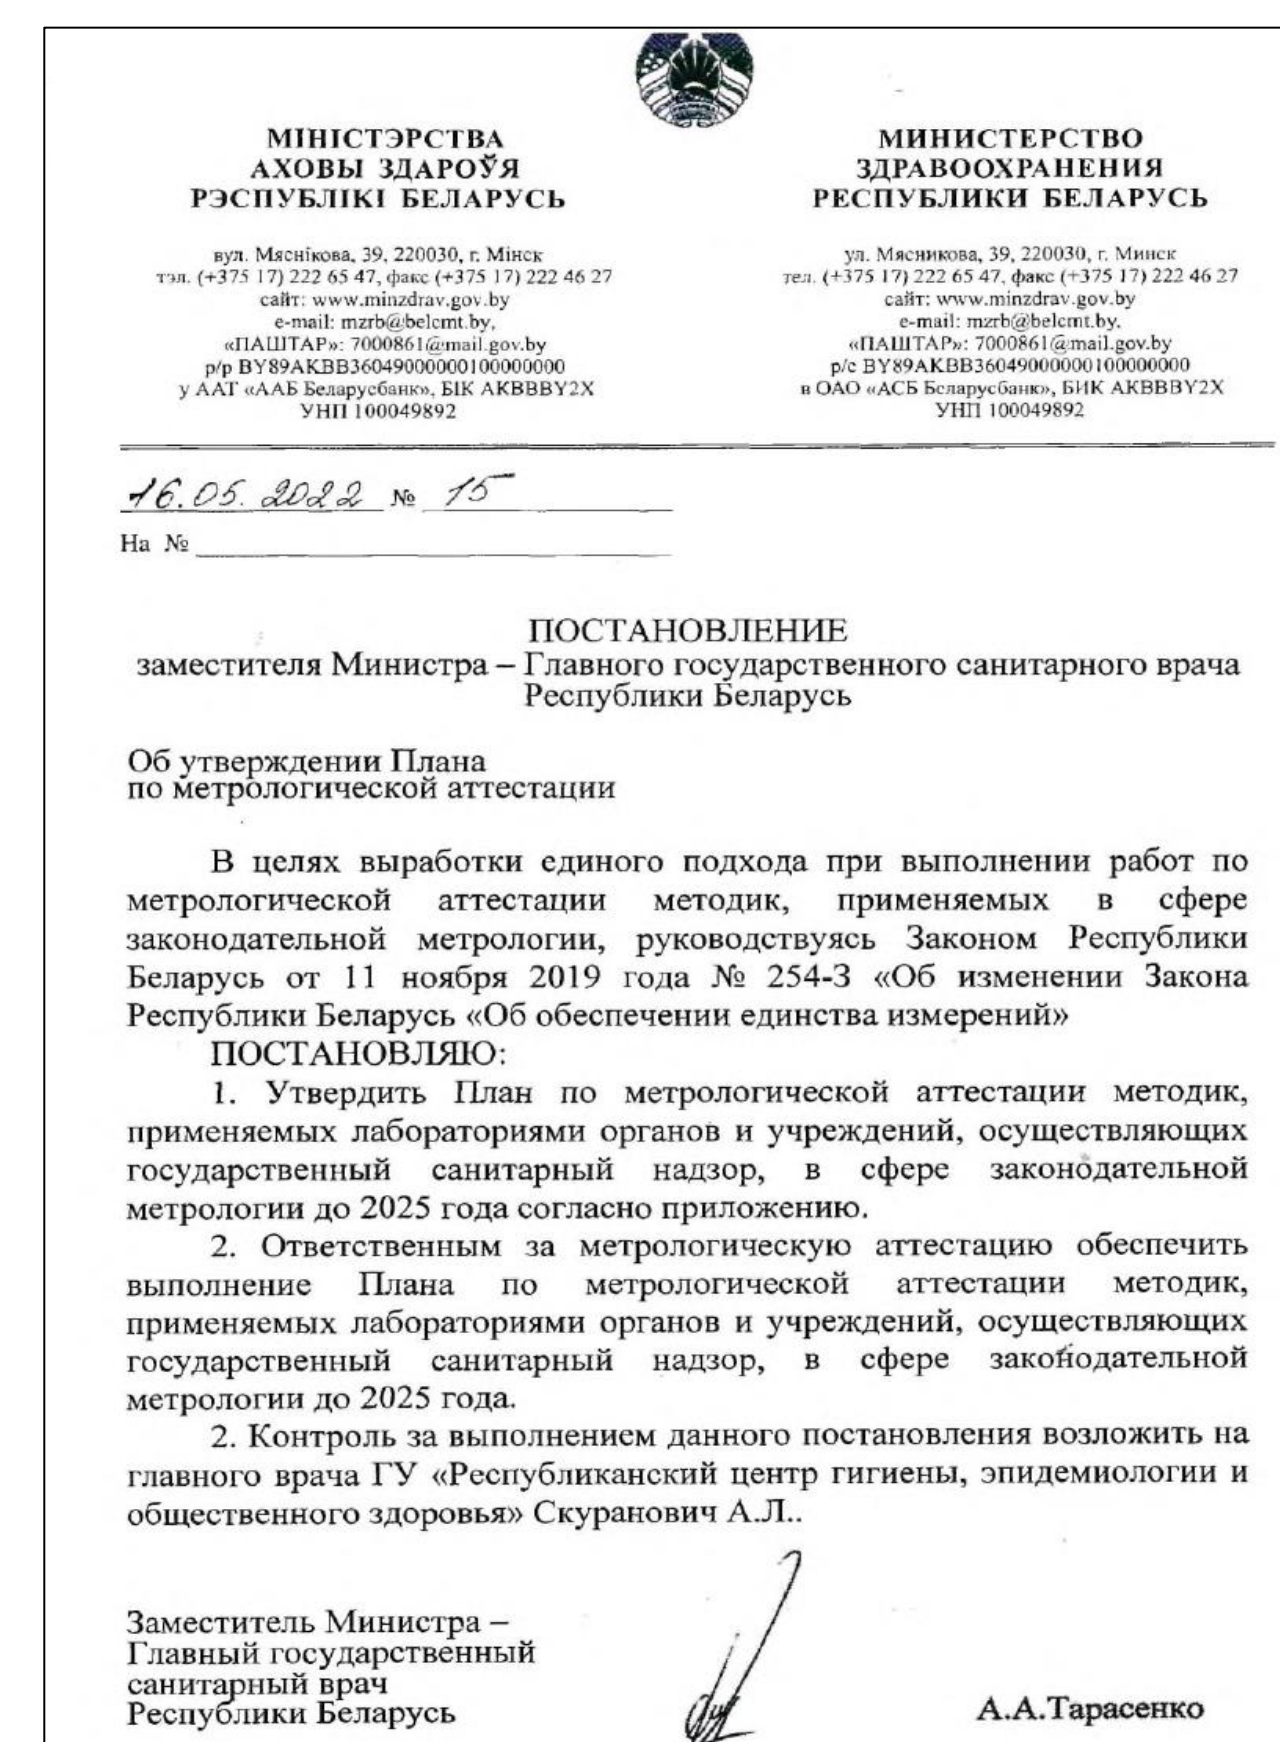

Список актуализирован – были удалены неперспективные устаревшие методики, а также методики, для которых уже не производятся средства измерения. В итоге осталось около 800 методик.

На основании этого был разработан и утвержден План по метрологической аттестации методик, применяемых лабораториями органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в сфере законодательной метрологии до 2025 года (далее – План), утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16.05.2022 № 15.

В соответствии с решением Республиканского Дня главного врача от 02.03.2023 центрами гигиены, РНПЦ гигиены и РНПЦЭИМ предоставлены дополнения в План, который был изложен в новой редакции, утвержденный постановлением заместителя Министра – Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 27.10.2023 № 22.

В ходе реализации Плана вносились изменения, так как вступали в действие метрологически аттестованные методы (методики), разработанные другими ведомствами, актуализировалась область аккредитации и внедрялись принятые новые ГОСТы.

На сегодняшний день в лабораторной практике продолжают применяться методы (методики) метрологически не аттестованные, не вошедшие в План, но которые остаются востребованы в лабораторной деятельности не только для лабораторного сопровождения государственного санитарного надзора, но и с целью выполнения требований ТР ТС.

В настоящее время в Республике Беларусь в лабораторной практике для выполнения требований национального законодательства в различных сферах, в том числе государственного санитарного надзора, применяются методики, не прошедшие метрологическую аттестацию, но включенные в перечни, необходимые для применения и исполнения требований к техническим регламентам Евразийского экономического союза и разрешенные к применению в соответствии с пунктом 5 статьи 38 Закона. Данные методики включены в «Программу межгосударственной стандартизации», в связи с чем считаем нецелесообразным проведение их метрологической аттестации.

Данная работа по переработке и метрологической аттестации методик, применяемых в лабораторной практике органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, будет продолжена.

Порядка 17 методик (методов), которые используются единичными центрами гигиены и эпидемиологии как для лабораторного сопровождения государственного санитарного надзора (так как это обусловлено спецификой регионов) так и с целью осуществления внебюджетной деятельности, будут в дальнейшем перерабатываться с последующей метрологической аттестацией лабораториями, использующими данные методики в своей деятельности.

